加一智聯

PIR-007

人體紅外線感應器

使用說明書

產品介紹

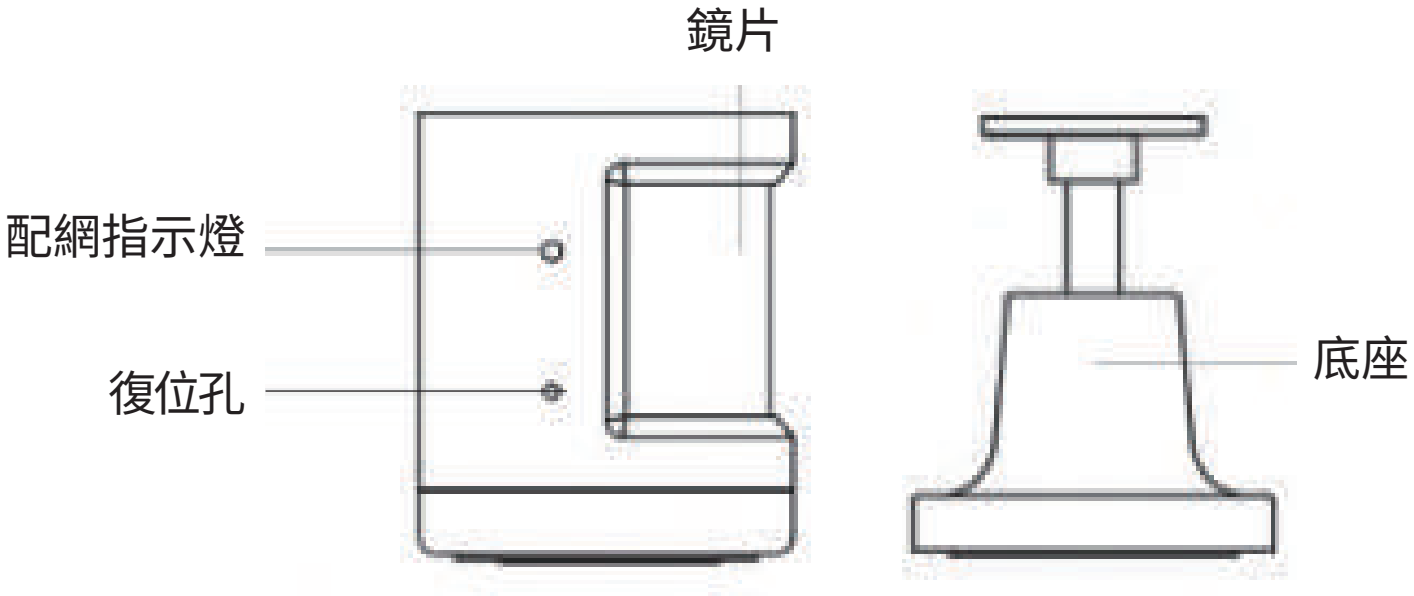

產品名稱:人體紅外線感應器
產品型號: PIR-007
通訊協議:ZigBee 3.0
供電方式:CR2450*1
產品重量:22.8g
產品尺寸:本體33*39.5mm/腳座31*37.6mm
安裝類型:立放、黏貼
※此產品需搭配多功能協調器一起使用

歡迎加入加一智聯APP

新增任何一樣設備之前

都需先下載「加一智聯」APP

請掃以下QR碼

IOS

Android

APP添加設備教學

PLUSONE

Step1 手機Wifi開啟之後，打開加一智聯 APP，點選右上角+添加設備：

Step 2 以卡針戳產品上的重設孔約五秒讓產品進入配對模式：

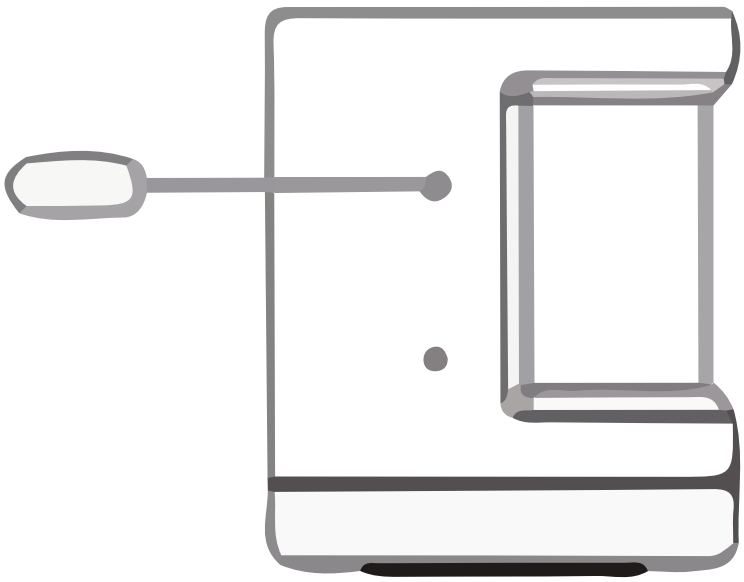

Step3 在添加設備介面中發現設備出現人體紅外線感應器圖示點選「添加」:

Step 4 出現1個設備，等待添加
選擇「下一步」：

Step5 添加成功後可以按 更改人體紅外線感應器的名稱\增加辨識度：

Step 6 配對成功，人體紅外線感應器出現在加一智聯 APP 內：

恢復出場預設值

PLUSONE

Step1 點選右上角 進入更多設定頁面。

Step2 進入介面，往上拉到最底
選擇「移除設備」項目。

Step3 選擇「解綁並清除數據」

Step4 選擇「確認」，解綁並清除數據完成。

※注意，裝置恢復出廠預設值後，將從APP列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

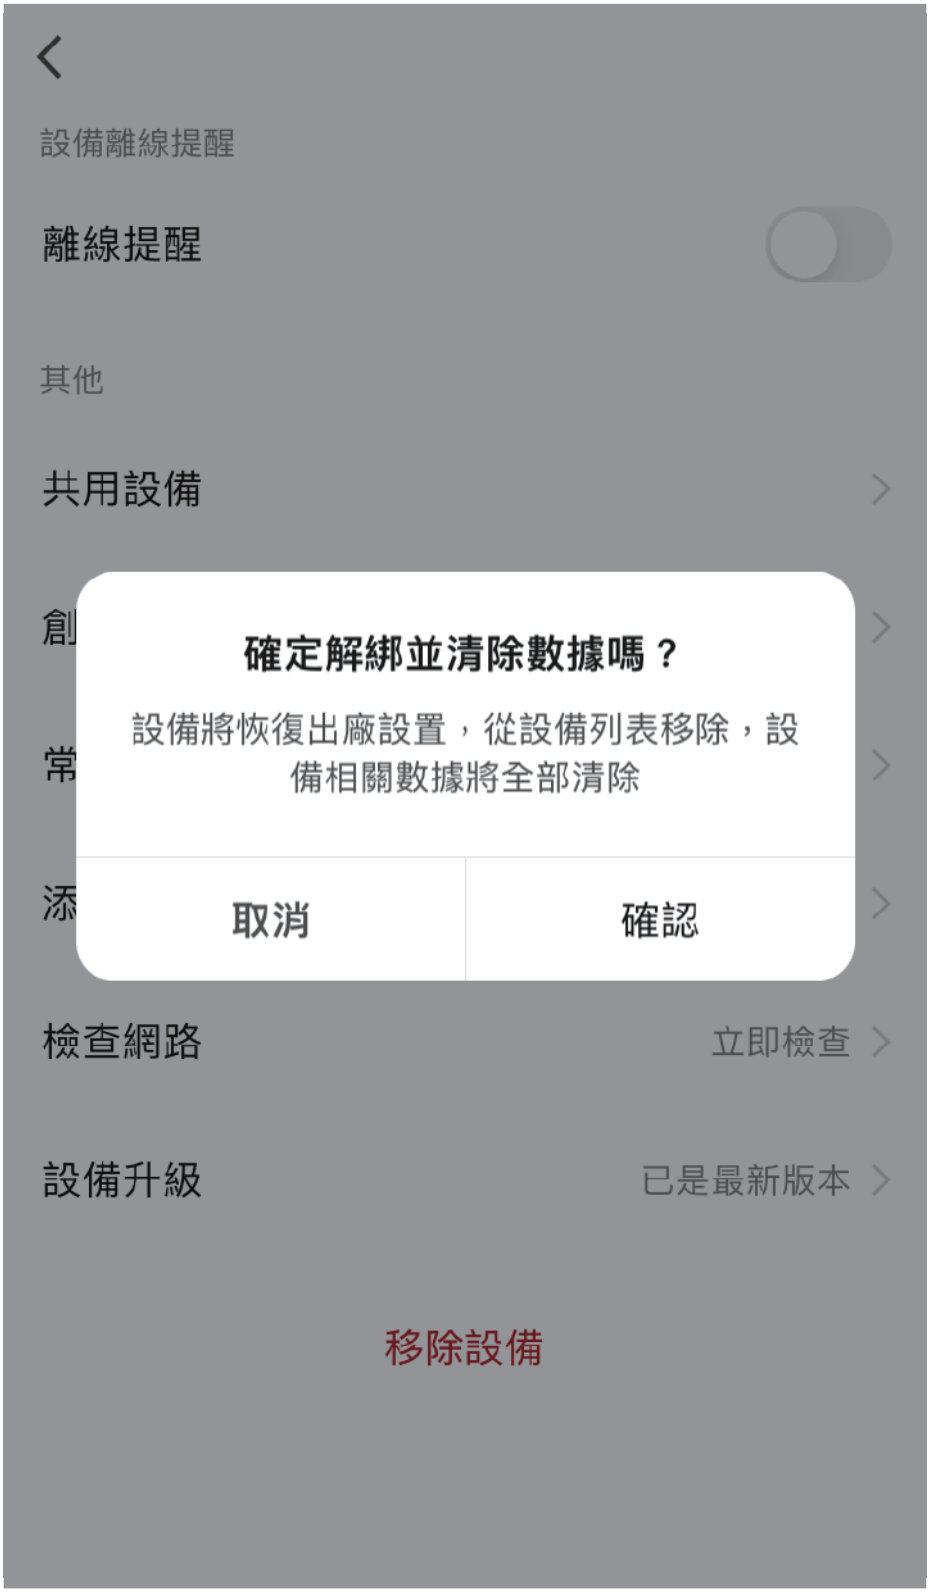

其它注意事項

PLUSONE

※不要放在潮溼、陽光直射的地方，避免造成人體紅外線感應器損壞，也建議不要放置在寵物、孩童易接觸的位置，避免意外發生。